

日時 年 月 日

Name
ID


身長 () cm
体重 () kg
前回体重 () kg

ウレタンフォーム硬度測定
※八幡ねじ、イノアック製
1;
2;【密度】20±2.0kg/m³
3;
4;【密度】35±3.0kg/m³
5;
6;【密度】50±5.0kg/m³
7;


〈下肢測定表／リンパ浮腫専門外来〉

※できるだけ「正確に」、
「丁寧に」測定お願い致します。


VAS; 痛み部位

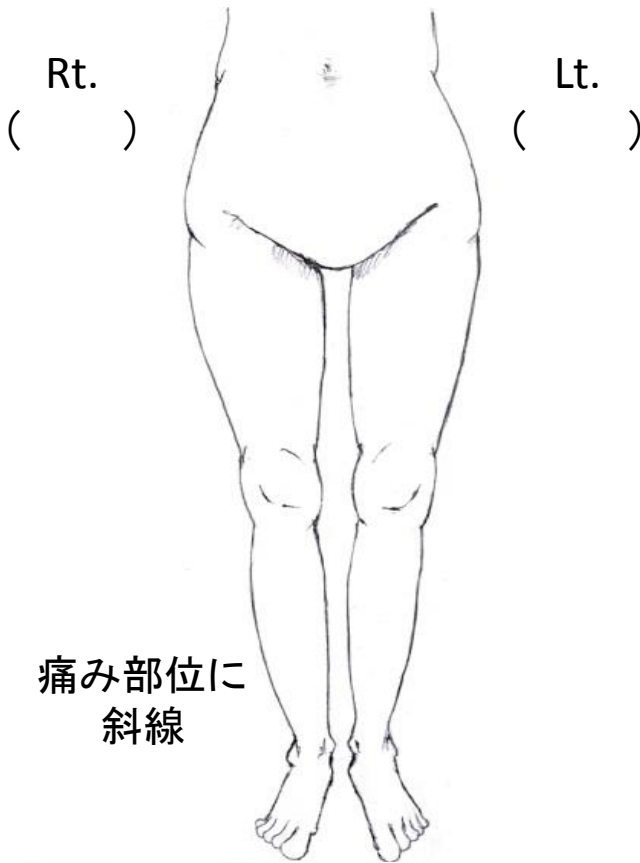

痛み部位に
斜線

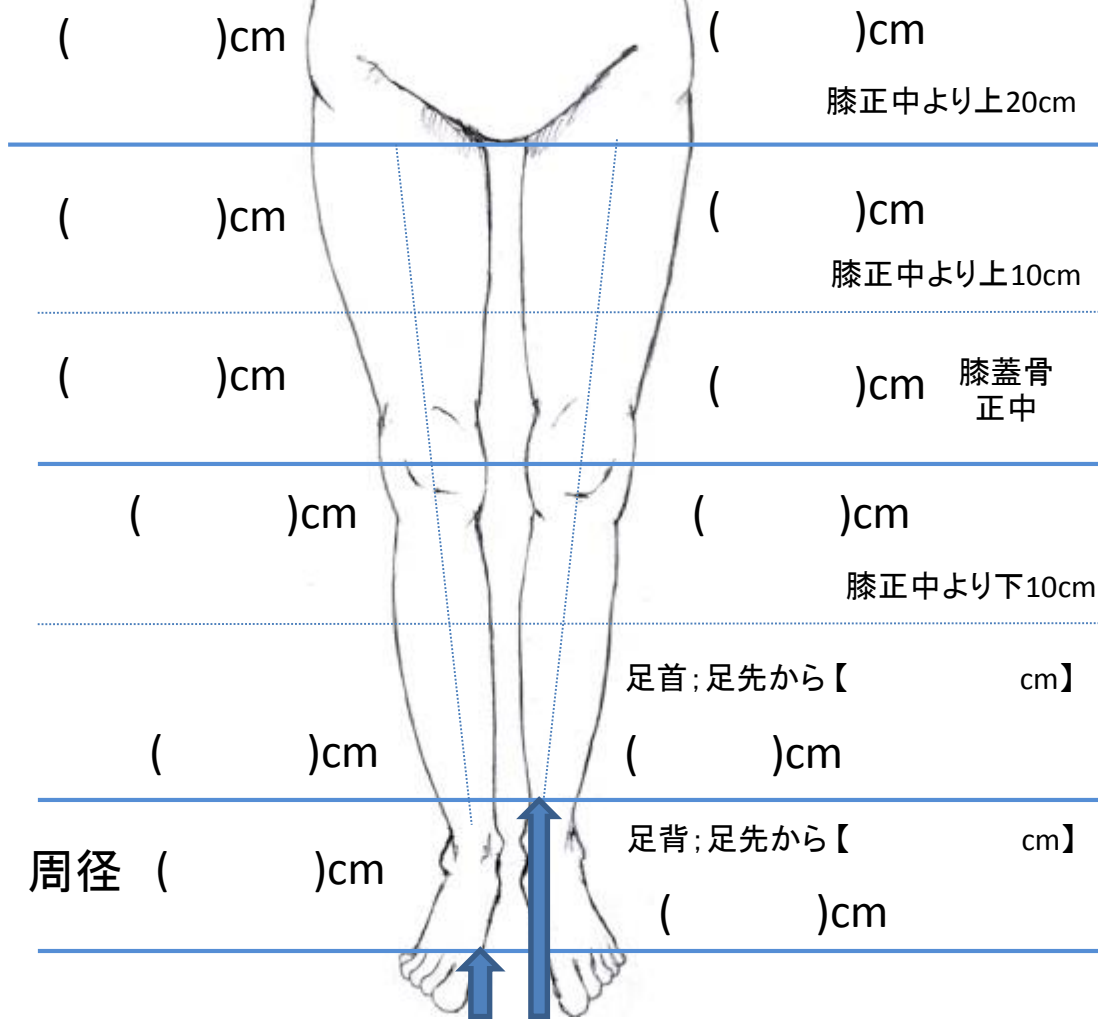

★治療する前の「」を数字の10とした場合、現在の痛み（症状）を〇で囲んでください。
(例) 少し良くなった感じであれば8 痛みが半分くらいになっていれば5



〈上肢測定表〉

ウレタンフォーム硬度測定



※八幡ねじ、イノアック製

- 1;
- 2; 【密度】 $20 \pm 2.0 \text{kg/m}^3$
- 3;
- 4; 【密度】 $35 \pm 3.0 \text{kg/m}^3$
- 5;
- 6; 【密度】 $50 \pm 5.0 \text{kg/m}^3$
- 7;

※できるだけ「正確に」、
「丁寧に」測定お願い致します。


Name
ID

VAS; 痛み部位

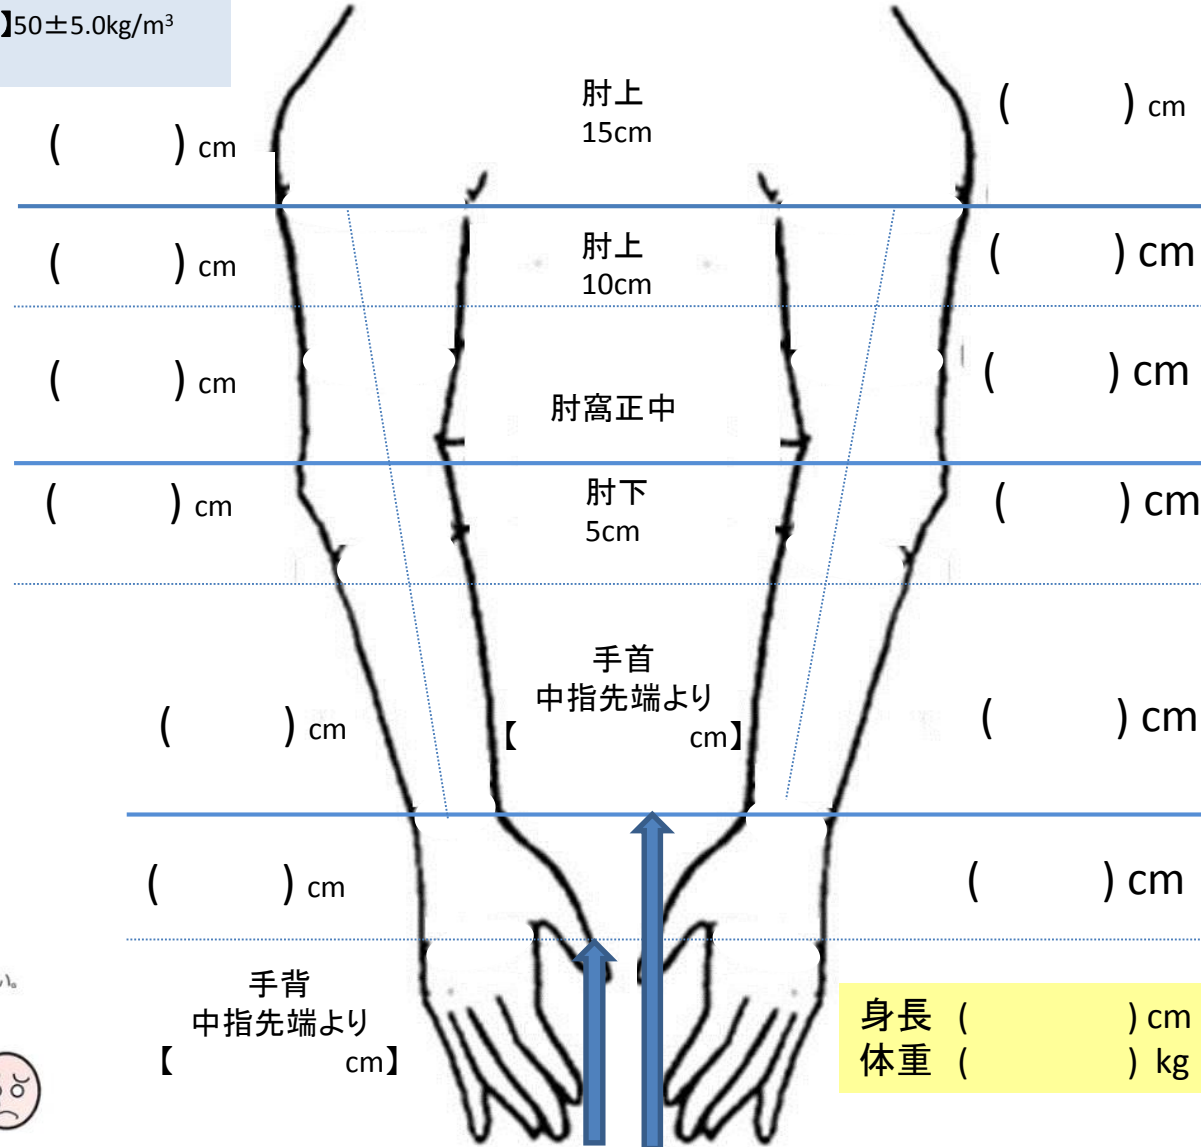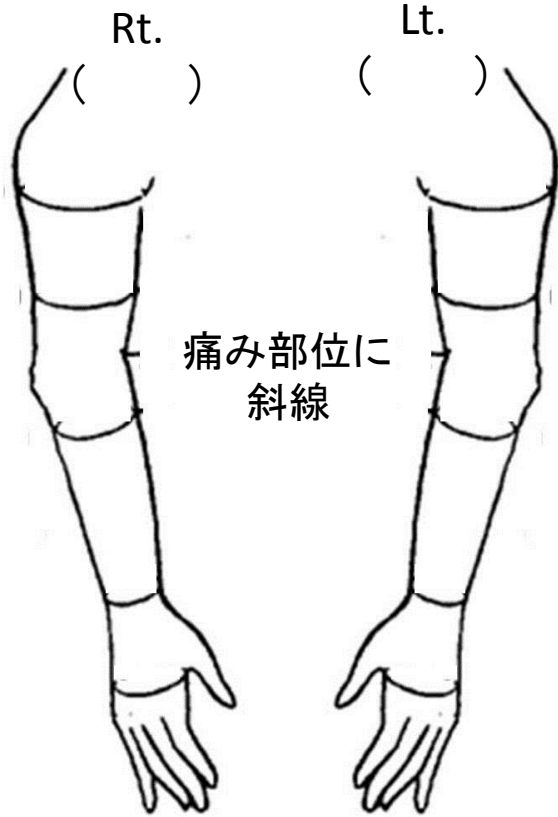

★治療する前の「」を数字の10とした場合、現在の痛み（症状）を〇で囲んでください。

(例) 少し良くなった感じであれば8 痛みが半分くらいになっていれば5



身長 () cm
体重 () kg